
	ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА		Издание: 1.0
	Вид на документа: Оперативен документ	№ на документа: 4.2.3_OD_1.6	В сила от: 14.09.2011
	Име на документа <i>Уведомително писмо/покана</i>		Страница: 1 от 1

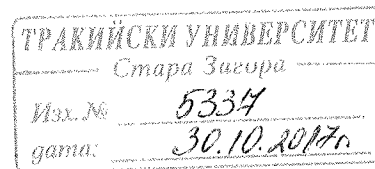

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

относно: обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“, с уник. № 00373-2017-0038, открита с Решение № 2381 от 12.10.2017 г.

В Тракийски университет гр. Стара Загора е постъпило е запитване, заведено с вх. № 5248 от 25.10.2017 г. На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

Въпрос: Производителят на Thermo Fisher Scientific на газов хроматограф TRACETM Ultra, за който ще се ползват консумативите, препоръчва използването на лайнери (втулки) с вътрешен диаметър 3 mm и 5mm. Считаме, че при изискването за „Втулка Restek за режим сплит и хедспейс за ГХ Thermo Ultra & Focus SSL с размери ID 1.0 mm x OD 8.00 mm x 105 mm дължина“ е допусната техническа грешка при изписване на вътрешен диаметър, а именно „ID 1.0 mm“ Бихме искали то да бъде променено на „ID 3.0 mm“?

Отговор: Не е допусната техническа грешка при посочване на отделните артикули в обособената позиция, тъй като при отделните режими на работа на апарата се използва посочения консуматив.

С уважение,
Ректор на Тракийски университет
гр. Стара Загора
(проф.двмн Иван ВЪШИН)



*Заместител ректор
чл. 23 от ЗЗП*